

# 分支机构添加流程

## 1. 机构关联集团

### 1.1. 集团二维码

操作：**集团账号**右上角点击系统设置，进入[集团信息](#)查看邀请码。

集团信息

邀请码: 708896

(邀请码为关联本集团的凭证, 下属机构可根据此邀请码申请加入集团管理: 超级管理员-系统设置-邀请码)

集团名称: 广东医疗集团-测试

所在地区: 广东省广州市天河区

详细地址: [模糊]

手机号: [模糊]

联系人: 广集

联系我们: [输入框]

社会信用代码: [模糊]

营业执照: 


集团网址: [输入框]

下载

- 初始化配置
- 集团信息
- 部门管理
- 人员账号
- 岗位权限
- 参数设置
- 数据字典
- 打印设置
- 消息模板
- 操作日志

## 2. 机构关联

操作：把邀请码给到所属机构，分支机构完成注册后，在**机构账号**右上角点击系统设置点击邀请码，输入邀请码，点击**确认**。

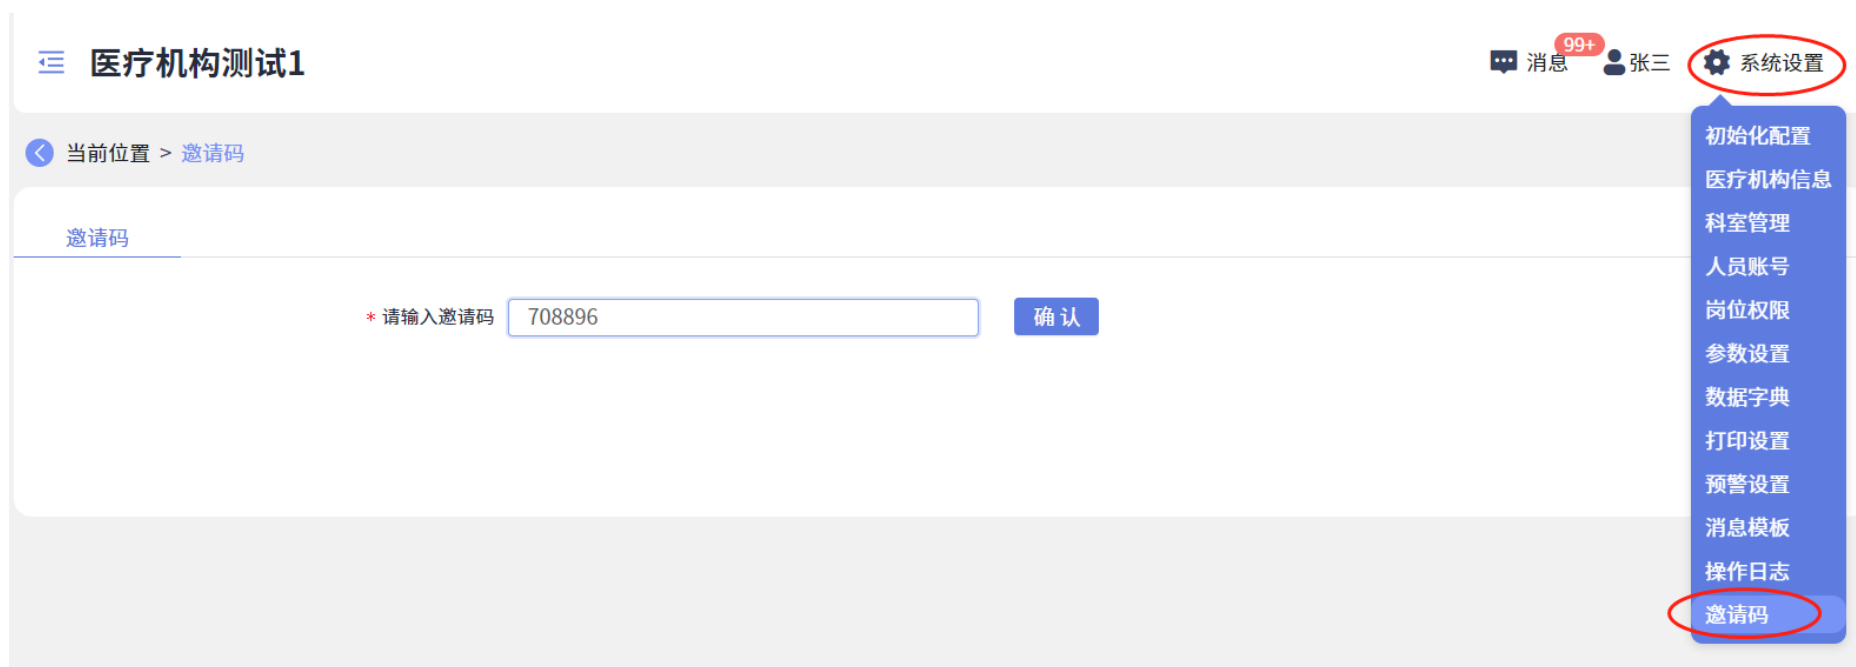

## 2.1. 提交

说明：机构账号授权允许上传给集团的数据（设备查看、设备调拨、设备维修查看、设备保养查看、设备计量查看、巡检统计、不良事件统计、保养预警、不良事件预警、推送工单到集团），提交后等待集团审核。

当前位置 > 加入集团

### 加入集团

\* 集团 广东医疗集团-测试

授权内容

<input checked="" type="checkbox"/> 设备查看	<input checked="" type="checkbox"/> 设备调拨			
<input checked="" type="checkbox"/> 设备维修查看	<input checked="" type="checkbox"/> 设备保养查看	<input checked="" type="checkbox"/> 设备计量查看	<input checked="" type="checkbox"/> 巡检统计	<input checked="" type="checkbox"/> 不良事件统计
<input checked="" type="checkbox"/> 保养预警	<input checked="" type="checkbox"/> 计量预警	<input checked="" type="checkbox"/> 巡检预警	<input checked="" type="checkbox"/> 不良事件预警	
<input checked="" type="checkbox"/> 推送工单到集团				

注：按需上传数据给集团

## 2.2. 审核

操作：**集团账号**点击左侧**分支机构管理**，点击**待审核**按钮，可以看到待审核通过的分支机构。

点击**详情**按钮，可以看到机构详细信息和加入集团申请。

医疗设备管理平台

广东医疗集团-测试

消息 2 超级管理员 系统设置

当前位置 > 分支机构管理 > 分支机构管理

待审核 1 已关联 全部

分支机构管理

符合当前条件机构数: 1 导出

医疗机构名称/所在地区 查询

序号	操作	状态	医疗机构名称	所在地区	地址	申请时间	联系人	手机
1	详情	待审核	医疗机构测试1	广东省广州市天河区	天鹰广场西塔	2023/5/18 11:30:52	张三	17701935212

点击详情进入审核页面

上一页 1 下一页 10条/页

## 2.3. 完成关联

操作：点击**审核**，完成关联。



医疗设备管理平台

广东医疗集团-测试

消息<sup>2</sup> 超级管理员 系统设置

当前位置 > 分支机构管理 > 医疗机构授权详情

医疗机构详情

点击审核完成关联

审核 审核不通过 导出PDF

系统资讯

当前科室数	当前人员数	当前授权设备数	当前预警计划	当前预警消息	当前登录人次	当前工单总数	注册时间
18	2	197	28	174	131	36	2021/12/28 10:03:50

机构详情

医疗机构名称: 医疗机构测试1 所在地区: 广东省广州市天河区 详细地址: 天鹰广场西塔

邮编: 联系我们: 传真:

完成关联后，可以从**集团账号**中，点击左侧菜单栏 - **设备管理**，查看已关联机构的所有设备及详情。

设备也可以通过输入关键词，通过设备名称、设备唯一码、设备编号进行查询。

- 首页
- 分支机构管理
- 设备管理
- 设备调拨
- 服务商管理
- 工单管理
- 维保作业
- 备件管理
- 备件调拨
- 报表统计
- 监控大屏

当前位置 > 设备管理 > 设备管理

设备管理

符合当前条件设备数: 685

输入关键词查找设备

导出

设备名称/设备唯一码/设备编号 查询 状态: 请选择 医疗机构: 请点击选择 清空

序号	操作	所属医疗机构	设备名称	设备状态	设备属性	所属主设备	设备编号	设备唯一码	规格	单位
1	详情	医疗机构测试1	裂隙灯	计量中	独立设备			000019	SL-2G	
2	详情	医疗机构测试1	拓普康眼压计	调拨中	独立设备			000020	CT-1	
3	详情	医疗机构测试1	牙科综合治疗台 普兰梅卡	正常	独立设备			000021	Compact1	
4	详情	医疗机构测试1	口腔X射线机; 牙科影像板扫描仪	正常	独立设备			000022	EZX-60; FireCR Dental	
5	详情	医疗机构测试1	X射线电子计算机体层螺旋扫描装置 (CT)	正常	独立设备			000023	SOMATOM Emotion 16、16排	
6	详情	医疗机构测试1	医用磁共振成像设备 (MR)	正常	独立设备			000024	MAGNETOM Skyra、3.0T	
7	详情	医疗机构测试1	放射性活度计 (PETCT)	正常	独立设备			000025	RM-905a	
8	详情	医疗机构测试1	放射性活度计 (PETMR)	正常	独立设备			000026	RM-905a	
环境监测用x-r										